

15ppm 油分濃度計の精度確認・点検較正についてのお願い

この製品は海洋環境保全監視の為に重要な機器です。また非常に精密な測定機器で使用年数により精度が劣化する可能性があります。精度の保証のためサービス代理店もしくは弊社による定期的な精度確認または弊社工場での点検較正が必要です。

1. MEPC60(33)適用 FOCAS-1500C 型について

- 製造後5年以上を経過している機器につきましては、出来るだけ早めのサービス代理店もしくは弊社による精度確認または弊社工場での点検較正をお受けになることをお奨めします。また1~2年毎に、弊社工場での点検較正またはサービス代理店による精度確認をお受けになることをお奨めします。

2. MEPC107(49)適用 FOCAS-1800/2000 型について

- 全ての機器に付いては出荷時下記の“精度証明書”が添付されております。ルールにより有効期限は発行後5年ですので、有効期限内に必ずサービス代理店または弊社による精度確認、もしくは弊社工場での点検較正をお受けください。または較正された機器との交換をお願いします。

FOCAS-1800 精度証明書

FOCAS-2000 精度証明書



- FOCAS-2000 型については別売のセンサユニット(較正証書付)交換により、5年毎の較正ができます。

- なお機器の精度を保つために、1~2年毎に、弊社工場での点検較正またはサービス代理店または弊社による精度確認をお受けになることをお奨めします。

★使用状況により精度が出ない場合は、本体交換などが発生しますので、事前に弊社または代理店にご確認ください。

(問合せ先)

- ・フェロー工業(株) 電話：03-3800-9777 FAX：03-3800-9770


ホームページ：<http://www.fellow-co.com>

- ・海外弊社代理店 ホームページ参照 <http://www.fellow-co.com>

- ・日本国内油水分離機メーカー殿 (ご使用されているメーカーにご確認ください)

FOCAS-1500C 正式証明書

FOCAS-1800/2000 正式証明書


FELLOW KOGYO CO., LTD.
 PRECISION CERTIFICATE
精度証明書
 Precision is proved as follows.
 下記の通り精度を証明します。


Certificate Number : Issued :


Model Name (IMEC No.)	
Model	FOCAS-1500C
Serial No.	
Date of manufacture	

That of India	Accuracy to set result
0 ppm	ppm
IF ppm to 6 ppm	ppm

That of date Service agent (Started by)	
	(Signature & Agent No.: FE)

Valid for one year after issued. 校正されたものは無効です。
 Valid for five years after issued. 有効期限は発行後5年です。


FELLOW KOGYO CO., LTD.
 〒118-0015 日本国千葉県千葉市美浜区
 栄4-8-15 株式会社フェロ工業
 TEL 03-5800-6111 FAX 03-5800-6110
 http://www.fellow.co.jp


FELLOW KOGYO CO., LTD.
 PRECISION CERTIFICATE
精度証明書
 Precision is proved as follows.
 下記の通り精度を証明します。

Certificate Number : Issued :

Model Name (IMEC No.)	
Model	FOCAS-1800
Serial No.	
Date of manufacture	

That of India	Accuracy to set result
0 ppm	ppm
IF ppm to 6 ppm	ppm

That of date Service agent (Started by)	
	(Signature & Agent No.: FE)

Valid for one year after issued. 校正されたものは無効です。
 Valid for five years after issued. 有効期限は発行後5年です。


FELLOW KOGYO CO., LTD.
 〒118-0015 日本国千葉県千葉市美浜区
 栄4-8-15 株式会社フェロ工業
 TEL 03-5800-6111 FAX 03-5800-6110
 http://www.fellow.co.jp

—FOCAS-2000 型—

最新機種 FOCAS-2000 は別売のセンサユニット(校正証明書)交換により
5年毎の校正に対応できます。

弊社または弊社海外代理店にセンサユニット(校正証明書)をご依頼願います。校正証明書のセンサユニットをお送りいたします。交換手順書が同梱されていますので、船員の方が交換できます。

FOCAS-2000 センサユニット校正証書


Precision certificate
精度証明書
 Precision is proved as follows.
 下記の通り精度を証明します。

Model	FOCAS-2000 Sensor unit
Serial No.	
Calibration value	
0ppm	ppm
1.5ppm	ppm
Date	年 月 日
Eng. number	年 月 日
Belong	年 月 日

What was corrected is invalid. 校正されたものは無効です。
 Valid for five years after issued. 有効期限は発行後5年です。


FELLOW KOGYO CO., LTD.
 118-0015 日本国千葉県千葉市美浜区
 栄4-8-15 株式会社フェロ工業
 TEL 03-5800-6111 FAX 03-5800-6110
 http://www.fellow.co.jp

参考：認定作業者の証明書サービス代理店認定作業者はこの証明書が発行されております。
ルールにより認定作業者以外は、精度確認作業ができません。

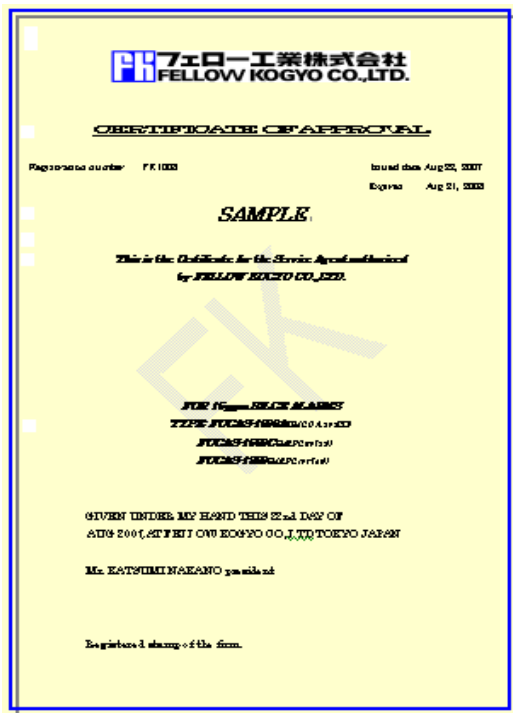

This certificate becomes invalid if your belonging company changes.

*2021年9月以降順次改訂

この証明書の無い作業者による
作業は全て無効となりますので
御注意願います。